

**SANTA CASA**  
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO


Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro  
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br  
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Janeiro de 2018

ANÁLISE TÉCNICA.

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 36/2017  
LOTE 1 – Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida



ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento ofertado pela empresa: Confiance Medical Produtos Médicos Ltda, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 36/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa Confiance Medical Produtos Médicos Ltda, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:
- 1) O edital solicita: 01 ( um ) Cabeçote da câmera imersível em líquidos e também passível de ser auto clavado por vapor ou plasma de peróxido de hidrogênio (sterrad) com objetiva com zoom parafocal 3 chips full-HD tecnologia CMOS, e acoplador de ótica universal e coupler com zoom ótico; com no mínimo 06 ( seis ) especialidades cirúrgicas pré-programáveis; alimentação bi-volt 110/220 automático;


Ofertado: A proposta está em desacordo com o edital. Conforme manual da Anvisa o produto cotado só pode ser esterilizado com solução de glutaraldeído.  
Conforme descreve no Manual. Pág. 8

“- Para esterilização utilize solução de glutaraldeído conforme as instruções dos respectivos fabricantes, desde que a temperatura permaneça entre -10°C e +50°C durante o processo.  
- A limpeza e desinfecção são os únicos procedimentos de manutenção preventiva que podem ser efetuados pelo usuário, para qualquer outra, contate nossa assistência técnica autorizada”.

Marca/Modelo: Innova/Confiance

Atenciosamente,

Dr. Tarcísio Silveira da Fonseca  
Cirurgião Geral  
CRMES 12198/ RQE 7866

  
Dr. Tarcísio Silveira da Fonseca  
CRM ES 12198  
Coordenador Centro Cirúrgico

9

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Janeiro de 2018

ANÁLISE TÉCNICA.

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 36/2017  
LOTE 1 – Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida



ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento ofertado pela empresa: AstusMed Technology Com de Equip. Médicos Eireli - Me, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 36/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa AstusMed Technology Com de Equip. Médicos Eireli - Me, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:
- 1) O edital solicita: 01 ( um ) Cabeçote da câmera imersível em líquidos e também passível de ser auto clavado por vapor ou plasma de peróxido de hidrogênio (sterrad) com objetiva com zoom parafoveal 3 chips full-HD tecnologia CMOS, e acoplador de ótica universal e coupler com zoom ótico; com no mínimo 06 ( seis ) especialidades cirúrgicas pré-programáveis; alimentação bi-volt 110/220 automático;

Ofertado: Na proposta informa claramente que não possui cabeçote da câmera imersível em líquidos.

- 2) O edital solicita: 01 ( um ) Sistema de captura e gerenciamento de imagens, com capacidade de armazenar e direcionar imagens e vídeos cirúrgicos de alta definição original ( 1080p ), controle através de tela sensível ao toque (touch screen), possibilidade de tirar fotos e gravar vídeo (online) com acionamento pelos botões do cabeçote da microcâmera, compatibilidade com sistema NTSC e com câmeras que geram imagens de Alta Definição ( Full HD ). Possibilita a gravação de imagens estáticas (fotos) e também dinâmicas (vídeos online) em um disco rígido interno de no mínimo 1TB, em mídias tipo CD e DVD e também em periféricos ligados a uma saída USB 2.0. Deverá ter capacidade de envio automático de imagens e dados para a rede do Hospital, para sistema PACS como também para equipamentos de impressão, deve ser compatível com formato DICOM. Deve ser de grau médico. Deve ser compatível com sistema de sala cirúrgica integrada podendo ser controlado remotamente por controle central touch screen e por voz da sala integrada.

Ofertado: Na proposta informa claramente que não possui controle do sistema de gerenciamento de imagens no cabeçote da câmera de vídeo.

- 3) O edital solicita: 01 ( hum ) Rack para equipamento de vídeo cirurgia com as seguintes características mínimas: — Laterais e portas em chapa de aço carbono. — Portas c/trava e chaves. — Porta frontal com vidro e traseira de metal perfurado. — Quatro rodízios linha hospitalar, dois com freio. — Prateleiras em chapa de aço, sendo que pelo menos 02 ( duas ) prateleiras contenham régua com 4 tomadas aterradas e filtro de linha cada régua — Furos laterais internos para ajustar a altura

9.



Rua Dr. Raulino de Oliveira, 45 - Centro  
Cx. Postal 45 - CEP 28.210-150  
Cachoeiro de Itaperiú - ES  
28.2101-2121 - 28.2101-2126 - 2101-2146  
www.santacasacachoeiro.org.br  
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

De Misericórdia de Cachoeiro de Itaperiú - CPE  
Nº 486  
Visto


das prateleiras. — que possua encaixe e suporte interno para cilindro de gás p/ insuflador. Pintura eletrostática a pó. Dimensões Externas e internas adequadas ao conjunto, que possa acomodar o monitor externamente e sobre o rack;

Ofertado: Na proposta informa claramente que não possui rack que acomoda o cilindro de gás, e tomadas aterradas nas prateleiras.

Marca/Modelo: AstusMedical

Atenciosamente,

Dr. Tarcísio Silveira da Fonseca  
Cirurgião Geral  
CRMES 12198/ RQE 7866

  
Dr. Tarcísio Silveira da Fonseca  
CRM ES 12198  
Coordenador Centro Cirúrgico





Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Cachoeiro  
Cx. Postal 45 - CEP 29300-197  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
28 2101-2121 · 28 2101-2126 · 2101-2146  
[www.santacasacachoeiro.org.br](http://www.santacasacachoeiro.org.br)  
[diretoria@santacasacachoeiro.org.br](mailto:diretoria@santacasacachoeiro.org.br)



Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Janeiro de 2018

### ANÁLISE TÉCNICA.

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 36/2017  
LOTE 1 – Sistema de Video Laparoscopia/ Endoscopia Rígida

#### ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento ofertado pela empresa: Stryker do Brasil Ltda, atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 36/2017.

#### CONCLUSÃO:

A empresa Stryker do Brasil Ltda, atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a sua habilitação foi aprovada. Portanto autorizo a Comissão Permanente de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item. Ressalvo, que na entrega do equipamento, o mesmo precisa ser verificado e analisado e demonstrando que seja o mesmo cotado na licitação.


Modelo: Stryker Endoscopy

Atenciosamente,

**Dr. Tarcísio Silveira da Fonseca**  
Cirurgião Geral  
CRMES 12198/ RQE 7866

Dr. Tarcísio Silveira da Fonseca  
CRM ES 12198  
Coordenador Centro Cirúrgico

g.



**SANTA CASA**  
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Raulino de Oliveira 67 - Centro  
Cx. Postal 45 - CEP 29301-900  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
28 2101-2121 - 28 2101-2125 - 2101-2116  
www.santacasacachoeiro.org.br  
diretoria@santacasacachoeiro.org.br



Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Janeiro de 2018

**ANÁLISE TÉCNICA.**

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 36/2017  
LOTE 2 – Cardioversor

**ANÁLISE TÉCNICA:**

O equipamento ofertado pela empresa: MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda, atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 36/2017.

**CONCLUSÃO:**


A empresa MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda, atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a sua habilitação foi aprovada. Portanto autorizo a Comissão Permanente de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item. Ressalvo, que na entrega do equipamento, o mesmo precisa ser verificado e analisado e demonstrando que seja o mesmo cotado na licitação.

Modelo: D3 + MP + SPO2  
Fabricante: Mindray

Atenciosamente,


Genivaldo *[Assinatura]*  
Suplente Técnico  
SANTACASA CREA-ES 032719-TD

*G.*



**SANTA CASA**  
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
CEP 28.210-2121 - 28.210-2125 - 2101-2146  
www.santacasacachoeiro.org.br  
diretoria@santacasacachoeiro.org.br



Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Janeiro de 2018

**ANÁLISE TÉCNICA.**

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 36/2017  
LOTE 2 – Cardioversor

**ANÁLISE TÉCNICA:**

O equipamento ofertado pela empresa: Fastmed Comércio Ltda Epp - Me, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 36/2017.

**CONCLUSÃO:**

- A empresa Fastmed Comércio Ltda Epp - Me, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:
- 1) O edital solicita: Modo de tela invertido de alto contraste.

Ofertado: No manual informa que não possui este tipo de recurso.

- 2) O edital solicita: Possuir seletor de energia com botão giratório para acionar a carga desejada e diretamente pelas pás.

Ofertado: No manual informa claramente que não possui controle do sistema de gerenciamento de imagens no cabeçote da câmera de vídeo.

- 3) O edital solicita: A bateria deve ser totalmente recarregada no Máximo 3 horas, no próprio aparelho.

Ofertado: No manual informa que não atende.

- 4) O edital solicita: Faixa de Frequência de pulso: 30 a 300 bpm Resolução: 1bpm,


Ofertado: No manual informa que atende na frequência de 30-254

- 5) O edital solicita: 7.4 A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações do Anexo – Termo de Referência, mas não poderá ser cópia literal destas, pois deverão estar descritas as especificações técnicas do objeto, inclusive marca, modelo e fabricação, sob pena de desclassificação.


Ofertado: Na proposta da empresa, a especificação técnica é idêntica ao edital.

Marca/Modelo: Lifemed - LifeShock Pro

Atenciosamente,

  
Genivaldo Palmazio  
\* Suporte Técnico  
SANTACASA CREA-ES 032719-TD

g.



Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Janeiro de 2018

ANÁLISE TÉCNICA.

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 36/2017  
LOTE 2 – Cardioversor

ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento ofertado pela empresa: Hominum Comércio de Produtos para Saúde Ltda, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 36/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa Hominum Comércio de Produtos para Saúde Ltda, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:
- 1) O edital solicita: Possuir seletor de energia com botão giratório para acionar a carga desejada e diretamente pelas pás.

Ofertado: No equipamento não possui.

- 2) O edital solicita: A bateria deve ser totalmente recarregada no Máximo 3 horas, no próprio aparelho.

Ofertado: Na proposta informa claramente que o equipamento é de até 4 horas.


- 3) O edital solicita: 4.1.8 Apresentar declaração de assistência técnica no Estado do Espírito Santo.

Ofertado: Na proposta informa claramente que não possui assistência técnica autorizada no Estado do Espírito Santo.

Marca/Modelo: Cmos Drake VIVO

Atenciosamente,

Genivaldo Dalmázio  
Suporte Técnico  
SANTACASA CREA-ES 036719-10



Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Janeiro de 2018

ANÁLISE TÉCNICA.

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 36/2017  
LOTE 2 – Cardioversor

ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento ofertado pela empresa: Prolife Equipamentos Médicos Eireli, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 36/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa Prolife Equipamentos Médicos Eireli, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:
- 1) O edital solicita: Slot para inserção de bateria recarregável tipo íon de Lítio com autonomia de operação para o aparelho de até 2,5 horas de monitoração ou até de 100 descargas em máxima energia.

Produto ofertado: Não atende.

- 2) O edital solicita: Modo de tela invertido de alto contraste.

Produto Ofertado: Não atende.

- 3) O edital solicita: O tempo de duração de bateria pode ser acompanhado através da tela do aparelho, ou através de indicador de nível incorporado.

Produto Ofertado: Não atende.

- 4) O edital solicita: Pesar no máximo 6,5kg com bateria

Produto Ofertado: Não atende (7,2kg)

- 5) O edital solicita: Identificação automática de que tipo de pá interna conectada, neonatal ou adulto, com seleção automática de carga.

Produto Ofertado: Não atende.


Marca/Modelo: CardioAid

Atenciosamente,

  
Genivaldo Dalnózio  
Suporte Técnico  
SANTA CASA CREA-ES 032719-TD

9.





**ATA DE JULGAMENTO**  
**PROCESSO DO EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE Nº. 36/2017**  
**CONVÊNIO MS SOB Nº. 799670/2013**

A equipe da Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia 08/01/2018, para análise da proposta enviada referente ao processo do edital de cotação eletrônica de nº. 36/2017, que contempla 3 (três) lotes para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Presentes: Pregoeiro da Instituição o Sr. Tonny Correa Machado e equipe de apoio, para análises técnicas: Dr. Tarcisio Silveira da Fonseca – Coordenador Centro Cirúrgico, Genivaldo Dalmasio – Engenharia Clínica, Nilzete Falcon de Freitas - Patrimônio Hospitalar e Paulo Sérgio, responsável pela manutenção hospitalar.

Análises:

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS - EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 36/2017								
Lote/Item	Fornecedor	Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Aprovado TR	Marca/Modelo	Status
1	AstusMed Tecnologia Com de Equip. Médicos Eireli Me	Sistema de Vídeo Laparoscopia/Endoscopia Rígida	1	190.500,00	190.500,00	210.000,00	AstusMedical	Desclassificada
	Stryker do Brasil Ltda			210.000,00	210.000,00		Stryker Endoscopy	Vencedora
	Confiance Medical Produtos Médicos Ltda			208.000,00	208.000,00		Innova/Confiance	Desclassificada
2	MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda	Cardioversor	5	26.400,00	132.000,00	132.500,00	Mindray D3+MP+SP02	Vencedora
	Hominum Comércio de Produtos para Saúde Ltda			21.947,48	109.737,40		Crnos Drake - Vivo	Desclassificada
	Fastmed Comércio Ltda Epp			21.000,00	105.000,00		Lifemed - LifeShock Pro	Desclassificada
	Prolife Equipamentos Médicos Eireli			21.000,00	105.000,00		Innomed - CardioAid	Desclassificada
3	MVM Indústria Metalúrgica Ltda Eppp	Escada com 2 degraus	30	184,00	5.520,00	6.000,00	MVM 902	
	S2 Saúde Ltda			195,00	5.850,00		Biomaster	
	Délcio Móveis Hospitalares Ltda			309,00	9.270,00		D. 580 E	
	Degraus Comércio e Serviços Eireli Me			183,00	5.490,00		UTI 5481	
	Tbios Industria e Serviços Eireli			230,00	6.900,00		BHIO - BE2102	
	Adovandro Luis Fraporti Me			182,50	5.475,00		ALC E20	Vencedora

**Lote/Item 1: Sistema de Vídeo Laparoscopia/Endoscopia Rígida:**

A empresa vencedora foi a Stryker do Brasil Ltda, portadora do CNPJ sob nº. 02.966.317/0002-93, no valor total de **RS 210.000,00** (Duzentos e dez mil reais), o valor se encontra dentro do termo de referência aprovado no Ministério da Saúde e as especificações técnicas foram aprovadas atendendo por completo o descritivo informado no termo de referência. **Portanto o processo está adjudicado.**

A empresa: **AstusMed Tecnologia Com de Equip. Médicos Eireli - Me – Me**, foi desclassificada por ofertar equipamento fora das especificações técnicas mínimas exigidas, a saber:

**Marca/Modelo: Marca/Modelo: AstusMedical**


- 1) O edital solicita: 01 ( um ) Cabeçote da câmera imersível em líquidos e também passível de ser auto clavado por vapor ou plasma de peróxido de hidrogênio (sterrad) com objetiva com zoom para focal 3 chips full-HD tecnologia CMOS, e acoplador de ótica universal e coupler com zoom ótico; com no mínimo 06 ( seis ) especialidades cirúrgicas pré-programáveis; alimentação bi-volt 110/220 automático;

Ofertado: Na proposta informa claramente que não possui cabeçote da câmera imersível em líquidos.

- 2) O edital solicita: 01 ( um ) Sistema de captura e gerenciamento de imagens, com capacidade de armazenar e direcionar imagens e vídeos cirúrgicos de alta definição original ( 1080p ), controle


9

9.



**SANTA CASA**  
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Paulino de Oliveira, 67 - Centro  
Cx. Postal 45 - CEP 28.008-150  
Cachoeiro de Itapemirim - RJ  
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 2101-2146  
www.santacasacachoeiro.org.br  
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

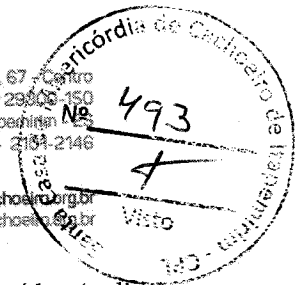

através de tela sensível ao toque (touch screen), possibilidade de tirar fotos e gravar vídeo (online) com acionamento pelos botões do cabeçote da microcâmera, compatibilidade com sistema NTSC e com câmeras que geram imagens de Alta Definição ( Full HD ). Possibilita a gravação de imagens estáticas (fotos) e também dinâmicas (vídeos online) em um disco rígido interno de no mínimo 1TB, em mídias tipo CD e DVD e também em periféricos ligados a uma saída USB 2.0. Deverá ter capacidade de envio automático de imagens e dados para a rede do Hospital, para sistema PACS como também para equipamentos de impressão, deve ser compatível com formato DICOM. Deve ser de grau médico. Deve ser compatível com sistema de sala cirúrgica integrada podendo ser controlado remotamente por controle central touch screen e por voz da sala integrada.

Ofertado: Na proposta informa claramente que não possui controle do sistema de gerenciamento de imagens no cabeçote da câmera de vídeo.

- 3) O edital solicita: 01 ( hum ) Rack para equipamento de vídeo cirurgia com as seguintes características mínimas: — Laterais e portas em chapa de aço carbono. — Portas c/trava e chaves. — Porta frontal com vidro e traseira de metal perfurado. — Quatro rodízios linha hospitalar, dois com freio. — Prateleiras em chapa de aço, sendo que pelo menos 02 ( duas ) prateleiras contenham régua com 4 tomadas aterradas e filtro de linha cada régua — Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras. — que possua encaixe e suporte interno para cilindro de gás p/ insuflador. Pintura eletrostática a pó. Dimensões Externas e internas adequadas ao conjunto, que possa acomodar o monitor externamente e sobre o rack;

Ofertado: Na proposta informa claramente que não possui rack que acomoda o cilindro de gás, e tomadas aterradas nas prateleiras.

**A empresa: Confiance Medical Produtos Médicos Ltda, foi desclassificada por ofertar equipamento fora das especificações técnicas mínimas exigidas, a saber:**

**Marca/Modelo: Marca/Modelo: Innova/Confiance**


- 1) O edital solicita: 01 ( um ) Cabeçote da câmera imersível em líquidos e também passível de ser auto clavado por vapor ou plasma de peróxido de hidrogênio (sterrad) com objetiva com zoom parfocal 3 chips full-HD tecnologia CMOS, e acoplador de ótica universal e coupler com zoom ótico; com no mínimo 06 ( seis ) especialidades cirúrgicas pré-programáveis; alimentação bi-volt 110/220 automático;

Ofertado: A proposta está em desacordo com o edital. Conforme manual da Anvisa o produto cotado só pode ser esterilizado com solução de glutaraldeído.  
Conforme descreve no Manual. Pág. 8

“- Para esterilização utilize solução de glutaraldeído conforme as instruções dos respectivos fabricantes, desde que a temperatura permaneça entre -10°C e +50°C durante o processo.

- A limpeza e desinfecção são os únicos procedimentos de manutenção preventiva que podem ser efetuados pelo usuário, para qualquer outra, contate nossa assistência técnica autorizada”.

8 9



**Lote/Item 2: Cardioversor:**

A empresa vencedora foi a MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda, portadora do CNPJ sob nº. 39.309.927/0001-43, no valor total de **R\$ 132.000,00** (Cento e trinta e dois mil reais), o valor se encontra dentro do termo de referência aprovado no Ministério da Saúde e as especificações técnicas foram aprovadas atendendo por completo o descritivo informado no termo de referência. **Portanto o processo está adjudicado.**

**A empresa: Hominum Comércio de Produtos para Saúde Ltda, foi desclassificada por ofertar equipamento fora das especificações técnicas mínimas exigidas, a saber:**

**Marca/Modelo: Marca/Modelo: Cmos Drake VIVO**

- 1) O edital solicita: Possuir seletor de energia com botão giratório para acionar a carga desejada e diretamente pelas pás.

Ofertado: No equipamento não possui.

- 2) O edital solicita: A bateria deve ser totalmente recarregada no Máximo 3 horas, no próprio aparelho.

Ofertado: Na proposta informa claramente que o equipamento é de até 4 horas.

- 3) O edital solicita: 4.1.8 Apresentar declaração de assistência técnica no Estado do Espírito Santo.

Ofertado: Na proposta informa claramente que não possui assistência técnica autorizada no Estado do Espírito Santo.

**A empresa: Fastmed Comércio Ltda Epp - Me, foi desclassificada por ofertar equipamento fora das especificações técnicas mínimas exigidas, a saber:**

**Marca/Modelo: Marca/Modelo: Lifemed - LifeShock Pro**

- 1) O edital solicita: Modo de tela invertido de alto contraste.

Ofertado: No manual informa que não possui este tipo de recurso.

- 2) O edital solicita: Possuir seletor de energia com botão giratório para acionar a carga desejada e diretamente pelas pás.

Ofertado: No manual informa claramente que não possui controle do sistema de gerenciamento de imagens no cabeçote da câmera de vídeo.

- 3) O edital solicita: A bateria deve ser totalmente recarregada no Máximo 3 horas, no próprio aparelho.

Ofertado: No manual informa que não atende.

- 4) O edital solicita: Faixa de Frequência de pulso: 30 a 300 bpm Resolução: 1bpm,

Ofertado: No manual informa que atende na frequência de 30-254

- 5) O edital solicita: 7.4 A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações do Anexo – Termo de Referência, mas não poderá ser cópia literal destas, pois deverão estar descritas as especificações técnicas do objeto, inclusive marca, modelo e fabricação, sob pena de desclassificação.


Ofertado: Na proposta da empresa, a especificação técnica é idêntica ao edital.

*[Handwritten signatures]*



Rua Dr. Raulino de Oliveira, Centro  
Cx. Postal 45 - CEP 28.200-158  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 28 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br  
diretoria@santacasacachoeiro.org.br



A empresa: Prolife Equipamentos Médicos Eireli, foi desclassificada por ofertar equipamento fora das especificações técnicas mínimas exigidas, a saber:

Marca/Modelo: Marca/Modelo: CardioAid

**Lote/Item 3: Escada de 2 degraus:**

A empresa vencedora foi a Adovandro Luiz Fraporti Me, portadora do CNPJ sob nº. 07.554.943/0001-05, no valor total de **RS 5.475,00** (Cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), o valor se encontra dentro do termo de referência aprovado no Ministério da Saúde e as especificações técnicas foram aprovadas atendendo por completo o descritivo informado no termo de referência. **Portanto o processo está adjudicado.**

**Resultados:**


Parabenizo as vencedoras:

Stryker do Brasil Ltda: LOTE: 1

MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda: LOTE: 2

Adovandro Luiz Fraporti Me: LOTE: 3

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 08 de Janeiro de 2018

  
Tonny Coirêa Machado

Pregoeiro SCMCI

Processo segue para Homologação da autoridade competente.

Eu, Evaldo Praça Ferreira, Superintendente e respondo como autoridade competente. Homologo o processo mediante adjudicações acima.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 12 de Janeiro de 2018


  
Evaldo Praça Ferreira

Superintendente



Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro  
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
28 2101-2121 · 28 2101-2126 · 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br  
diretoria@santacasacachoeiro.org.br



**ATA DE JULGAMENTO – COMPLEMENTAR.  
PROCESSO DO EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE Nº. 36/2017  
CONVÊNIO MS SOB Nº. 799670/2013**

A equipe da Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia 08/01/2018, para análise da proposta enviada referente ao processo do edital de cotação eletrônica de nº. 36/2017, que contempla 3 (três) lotes para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Presentes: Pregoeiro da Instituição o Sr. Tonny Correa Machado e equipe de apoio, para análises técnicas: Dr. Tarcisio Silveira da Fonseca – Coordenador Centro Cirúrgico, Genivaldo Dalmasio – Engenharia Clínica, Nilzete Falcon de Freitas - Patrimônio Hospitalar e Paulo Sérgio, responsável pela manutenção hospitalar.

A Comissão de Licitação, informa que houve equívoco de lançamento. O Lote/Item 3 – Escadinhas de 2 degraus, objeto já licitado anteriormente no Edital de Cotação Eletrônica de nº. 34/2017. Portanto cancelamos o Lote/Item 3 – Escadinhas de 2 degraus.

Assim, a Comissão cancela este item já licitado.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 08 de Janeiro de 2018

Tonny Correa Machado

Pregoeiro SCMCI