

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Eireli
A/C: Sra. Claudia Cristina Corrêa César

Convênio Nº: 959429/2024

Cotação Prévia de Preços Nº: 002/2025

Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico Nº: **002/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] **Tela touchscreen colorida externa ao corpo do ventilador de no mínimo 17 polegadas** com no mínimo 4 curvas simultâneas na tela e com layout configurável.
[...]"

“[...] **Fluxo: 1 a 120 L/min** [...]"

“[...] **Índice C20/C** [...]"

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o desritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Fabricante: Bio Infinity

Modelo: Prunus Padus 6

Quantidade: 02 Unidades

Registro: 80117580997



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA Nº: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A Magnamed Tecnologia Médica S/A

A/C: Srs. Paulo Henrique Fernandes Spolaor e Tiago Veiga Vieira de Souza

Convênio Nº: 959429/2024

Cotação Prévia de Preços Nº: 002/2025

Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico Nº: **002/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] **Tela touchscreen colorida externa ao corpo do ventilador de no mínimo 17 polegadas** com no mínimo 4 curvas simultâneas na tela e com layout configurável. [...]”

“[...] Possibilidade de recursos avançados como **NAVA, SmartCare, PAV+, ASV, AVA ou aplicativo de protocolo de avaliação, recrutamento** e titulação de PEEP por mecânica ventilatória. [...]”

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o desritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Fabricante: Magnamed

Modelo: Fleximag Max 500

Quantidade: 02 Unidades

Registro: 80659160005



Gustavo Godoi Vieira

Engenheiro Eletricista - CREA Nº: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A Priom Tecnologia em Equipamentos
A/C: Sr. Rodrigo Benjamin Delgado

Convênio N°: 959429/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 002/2025

Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico N°: **002/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] **Tela touchscreen colorida externa ao corpo do ventilador de no mínimo 17 polegadas** com no mínimo 4 curvas simultâneas na tela e com layout configurável. [...]”

“[...] **Deve realizar ventilação mecânica em pacientes recém-nascidos até adultos.** [...]”

“[...] Controle de ciclagem à tempo, fluxo ou a relação com **compensação de fuga e compensação de tubo** [...]”

“[...] Modos ventilatórios invasivos: Pressão controlada com volume garantido, Volume Controlado com Volume garantido, PRVC, SIMV, PS, **VS**, APRV e CPAP [...]”

“[...] **Possibilidade de recursos avançados como NAVA, SmartCare, PAV+, ASV, AVA ou aplicativo de protocolo de avaliação, recrutamento e titulação de PEEP por mecânica ventilatória.** [...]”

“[...] **Modos não invasivos: Pressão controlada com volume garantido, SIMV em PS, CPAP, PS, APRV e oxigenoterapia (alto fluxo);** [...]”

“[...] **Monitorização da Pressão Transpulmonar;** Disparo à fluxo ou à pressão; Botão de hiperoxigenação para manobra de aspiração; Conectividade com equipamentos externos; Autoteste ao ligar; Correção do volume corrente em BTPS; Modo de Backup no mínimo nos modos espontâneos; P0.1 e NIF(Pimax); Teste de Respiração espontânea (TRE ou SBT); Curva P/V; Aspiração em circuito aberto; Manobra de Pausa Inspiratória; Manobra de Pausa Expiratória; Botão de ajuda com definição de parâmetros; **possibilidade de capnografia Volumétrica**; Alarmes: Pressão alta de vias aéreas; [...]”

“[...] **Volume Corrente (VT): 2 - 2000 ml** [...]”

“[...] **Pressão de Suporte: 0 - 80 cmH20** [...]”

“[...] **Fluxo: 1 a 120 L/min;** [...]”

“[...] **Frequência respiratória: 1 - 150 rpm** [...]”

“[...] Disparo: À pressão - 0,1 a -15 cmH20, **à fluxo 0,2 a 15 L/min** [...]”

“[...] **Driving pressure**(pressão motriz). Volume corrente e volume expirado; Volume minuto; Índice de Tempo inspiratório / Tempo Total; PEEP e PEEP intrínseca (Auto-PEEP); Tempo inspiratório, Tempo expiratório e Constante de Tempo; Vazamento: % de Fuga; Volume corrente em fuga; **WOB, IRR, IRRS; Índice C20/C;** [...]”

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o desritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Fabricante: CMOS DRAKE S.A

Modelo: RUAH

Quantidade: 02 Unidades

Registro: 80058130025



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A Tecme do Brasil Comércio e Importação Ltda
A/C: Sra. Pâmela Nunes Rosado Giamarino

Convênio N°: 959429/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 002/2025

Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico N°: **002/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] **Sensor de fluxo com filamento aquecido ou ultrassônico ou sensor mecânico de área variável proximal ao paciente [...]**”

“[...] **05 sensores de fluxo [...]**”

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o desritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Fabricante: Tecme

Modelo: Brina

Quantidade: 02 Unidades

Registro: 80279421100



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

A/C: Sr. Tetsuya Deyama.

Convênio N°: 959429/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 002/2025

Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **002/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Fabricante: NIHON KOHDEN


Modelo: NKV-550

Quantidade: 02 Unidades

Registro: 80914690040



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREAN°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

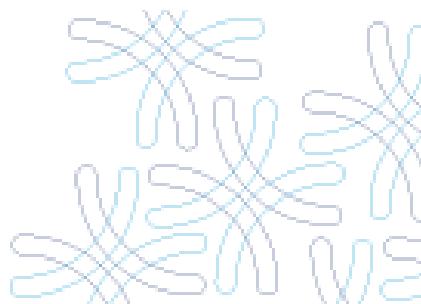

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de dezembro de 2025.

A Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde LTDA
A/C: Sra. Fabiula Maria da Silva

Convênio N°: 959429/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 002/2025

Item: Foco Cirúrgico de Teto

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico N°: **002/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] Deverá possuir sistema de iluminação ambiente, para cirurgias minimamente invasivas, através de botão específico. [...]”

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o desritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Foco Cirúrgico de Teto

Fabricante: Mendel Medical

Modelo: Foco Cirúrgico Teto LED Duplex 4LEV/4LEV

Quantidade: 02 Unidades

Registro: 81205910005



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de dezembro de 2025.

A MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E Com. De PROD
A/C: Sra. Luidy de Moraes Ladeira

Convênio N°: 959429/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 002/2025

Item: Foco Cirúrgico de Teto

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **002/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Foco Cirúrgico de Teto

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: APOLLO FT200 4X4 SAT

Quantidade: 02 Unidades

Registro: 80712710009



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREAN°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

